

INFORMATION

No. 2205-19

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、2022年6月1日(水)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
0560	HIV-抗原・抗体 ^{※1}	報告形態 ・基準値	判定：陰性 S/CO値：1.00未満	判定：陰性
		区分番号・ 保険請求 名称	D012-19 HIV-1, 2抗原・抗体 同時測定定量	D012-16 HIV-1, 2抗原・抗体 同時測定定性
		実施料	127点	112点
4537	SARS-CoV-2抗体	報告範囲 (COI)	上限値：最終値 下限値：0.1未満	上限値：100.0以上 下限値：1.0未満
1281	HCV抗体 ^{※2}	判定基準	(-)：1.00未満 (+)：1.00以上	(-)：1.00未満 (±)：1.00～6.99 (+)：7.00以上

※1 測定試薬の診療報酬適用区分変更のため、定量報告となります。

※2 同メーカーの改良試薬に変更のため。

(裏面に続く)

■変更日

2022年 6月 1日(水) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。


〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

HCV 相関図

〈相関図〉

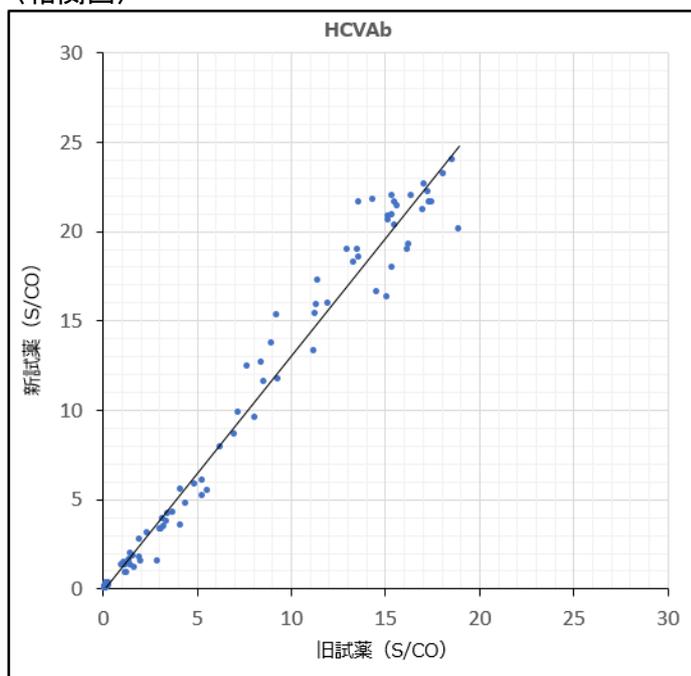

n=115
 $y(\text{新}) = 1.31x(\text{旧}) - 0.15$
 $r=0.990$

〈判定一致率〉

		旧試薬		計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	83	0	83
	(-)	2	30	32
計		85	30	115

陽性一致率 : 97.6% (83/85)
陰性一致率 : 100.0% (30/30)
判定一致率 : 98.3% (113/115)

(社内検討データ)

注 旧試薬の(±)は(+)として判定しています。

■ 変更日

2022年 6月 1日(水) 受領分より