

INFORMATION

No. 2211-37

採取容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目の検体採取容器「癌胎児性フィブロネクチン用容器（容器番号：01）」において、本容器の検体抽出液入り容器のキャップの色と、検体保存チューブのキャップ形状を変更する旨の連絡がございましたので、順次容器を変更させていただきます。なお、この変更に伴う受託要領等の変更はございません。


先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容

対象検査項目： [コード;2858] 癌胎児性フィブロネクチン

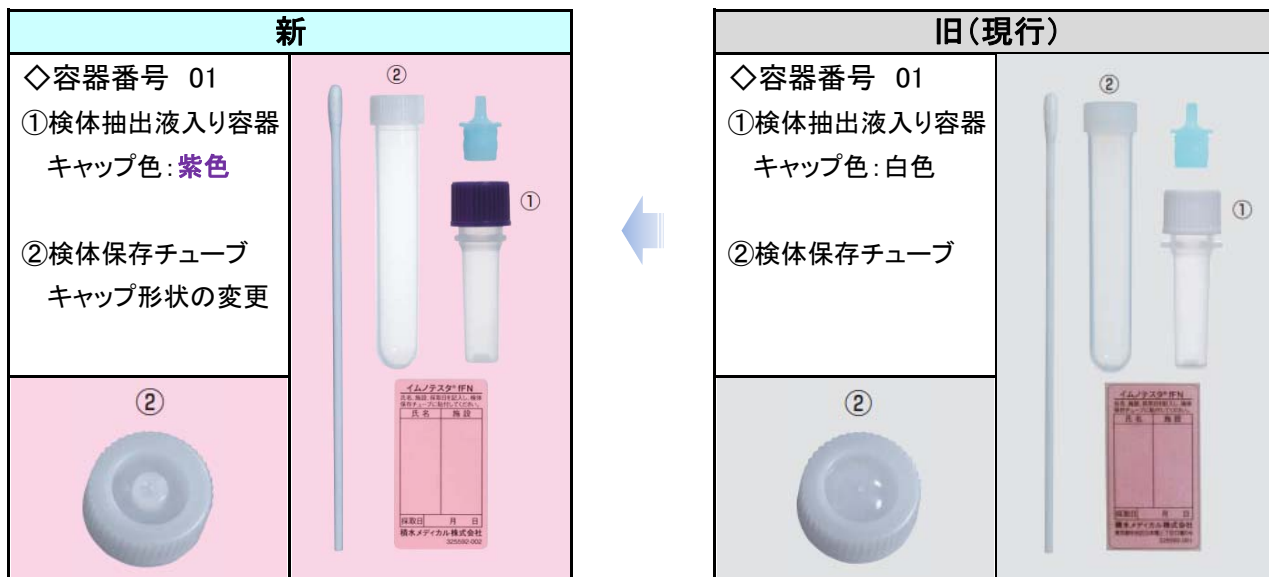

■変更日

在庫状況に応じて順次切替えさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。