

INFORMATION

No. 2002-01

採取容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記項目の検体採取容器「PCR専用試験管(容器番号:05)」が製造販売中止されることに伴い、同一メーカーが販売する代替容器に変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。


先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

対象検査項目: [コード;0560] HIV-抗原・抗体
[コード;0561] HIV-1抗体<<確認試験>>
[コード;0562] HIV-2抗体<<確認試験>>

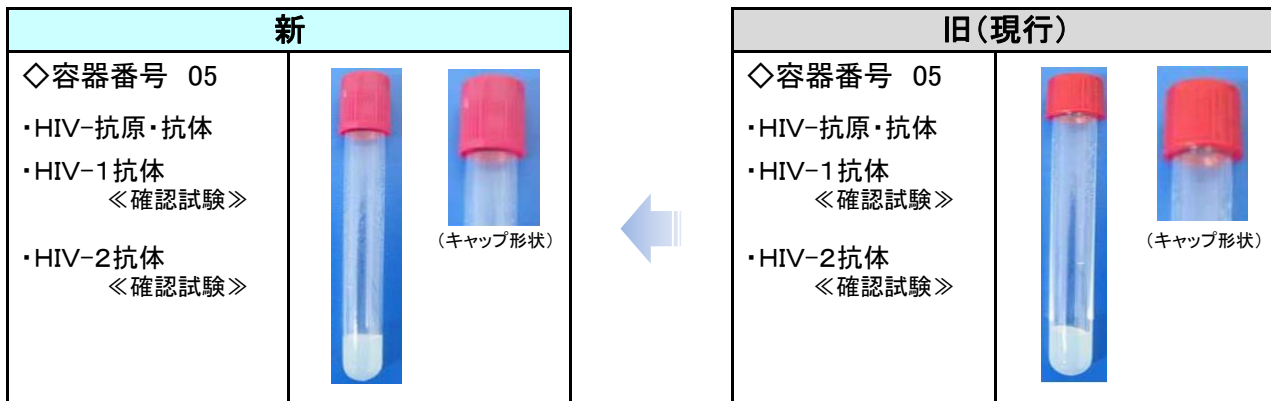

- ・キャップ形状および金型が変更になりましたが、材質については変更ありません。
- ・凝固剤および分離剤に変更はありません。
- ・梱包数が、50本(トレイ)入りから100本(箱)入りに変更されました。(※従来通り、少数でもお届け致します。)

■変更日

2020年 2月中旬以降、在庫状況に応じて順次切替えさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>